

2.20 ห้องตรวจภายในและชุดมดลูก

ผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการตรวจภายในและชุดมดลูก มารับบริการที่งานการพยาบาลผู้คลอดรวมทั้งการรับไว้นอนที่โรงพยาบาล

2.20.1 ชุดอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อย 1 ชุด

2.20.2 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหายใจ


2.20.3 โคมไฟหรืออุปกรณ์แสงสว่างเพื่อการตรวจภายใน

2.20.4 เตียงสำหรับใช้ตรวจภายในและใช้ชุดมดลูก

2.20.5 ชุดตรวจภายในและชุดชุดมดลูกที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

2.20.6 อ่างฟอกมือที่ไม่ใช้มือ เปิด-ปิดน้ำ

- ห้องรับผู้ป่วยไว้นอนหลังทำหัตถการชุดมดลูก

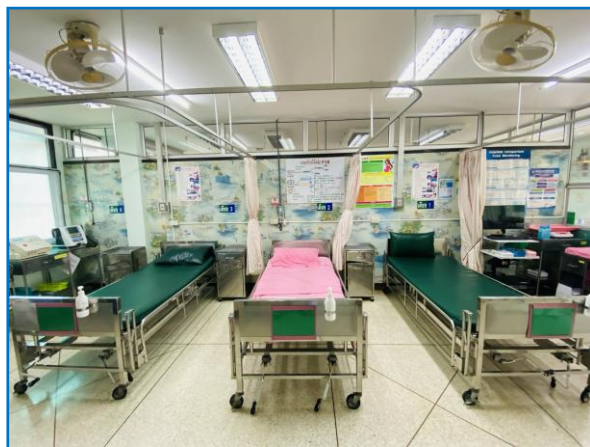

- รถ Emergency อุปกรณ์และยาช่วยฟื้นคืนชีพ




- ระบบแก๊สออกซิเจนบริเวณหัวเตียง ถึงออกซิเจนสำรองและเครื่องดูดเสมหะ



- ระบบเรียกขอความช่วยเหลือ กริ่งเรียกขอความช่วยเหลือบริเวณหัวเตียงทุกเตียง และห้องน้ำ






- รถเตรียมยา Treatment , เครื่องอัลตราซาวด์

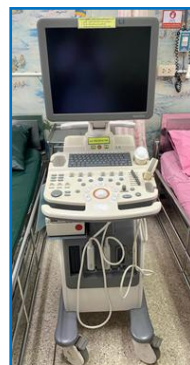

ห้องคลอดและห้องทำหัตถการตรวจภายใน ชุมมดลูก

ประกอบด้วย

- เตียงคลอดและทำหัตถการตรวจภายใน, โคมไฟ

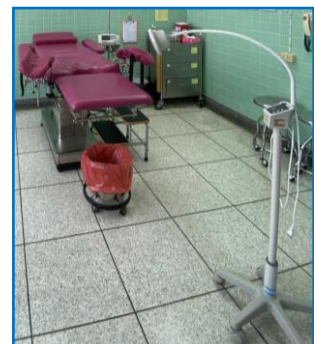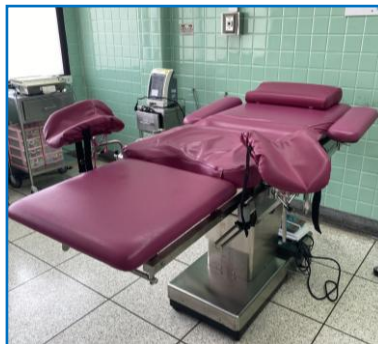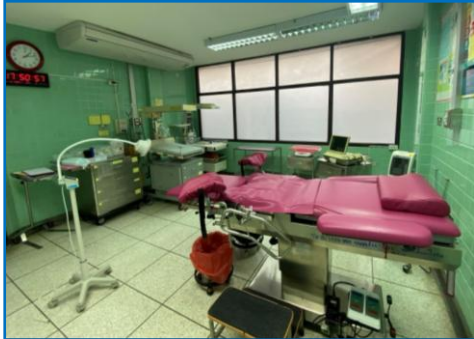

-รถ Emergency อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ



- ระบบแก๊สออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะ



- เครื่องวัดสัญญาณชีพ, รถเตรียมยา



- Set ผ้าและเครื่องมือ Curettage



- อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดน้ำในห้องคลอด

